



1943'den Günümüze; Güvenilir, Gerçek Kalite



DİŞ HEKİMLİĞİ CİHAZLARI

DENTAL UNIT
Correcta S



Cerrahi müdahaleler için
serumu mikromotor ve
anguldurvalarına bağlama imkanı



Miknatıslı alet koyma yeri,
kolayca yerinden
çkarılıp temizlenebilir.
Silikon örtüsü otoklavda
sterilize edilebilir.



Silikon örtü
kolayca çıkarılıp
temizlenebilir,
otoklavda sterilize
edilebilir.




Correcta S Tablet kamçı sistemi
5 çıkışlı olarak hazırlanmıştır.

Tüm çıkışlar istenilen
enstrümana göre dizayn edilir.

Her çıkışın ayrı-ayrı kumanda edilen
su ve hava regülatörü vardır.

Hijyenik malzemeden üretilen
kumanda paneli geniş LCD ekranı ile
tablet üzerinden Kraşuvan, Bardaklık,
Reflektör, Negatoskop ve
Koltuk hareketlerine
kumanda etme imkanı sunar.

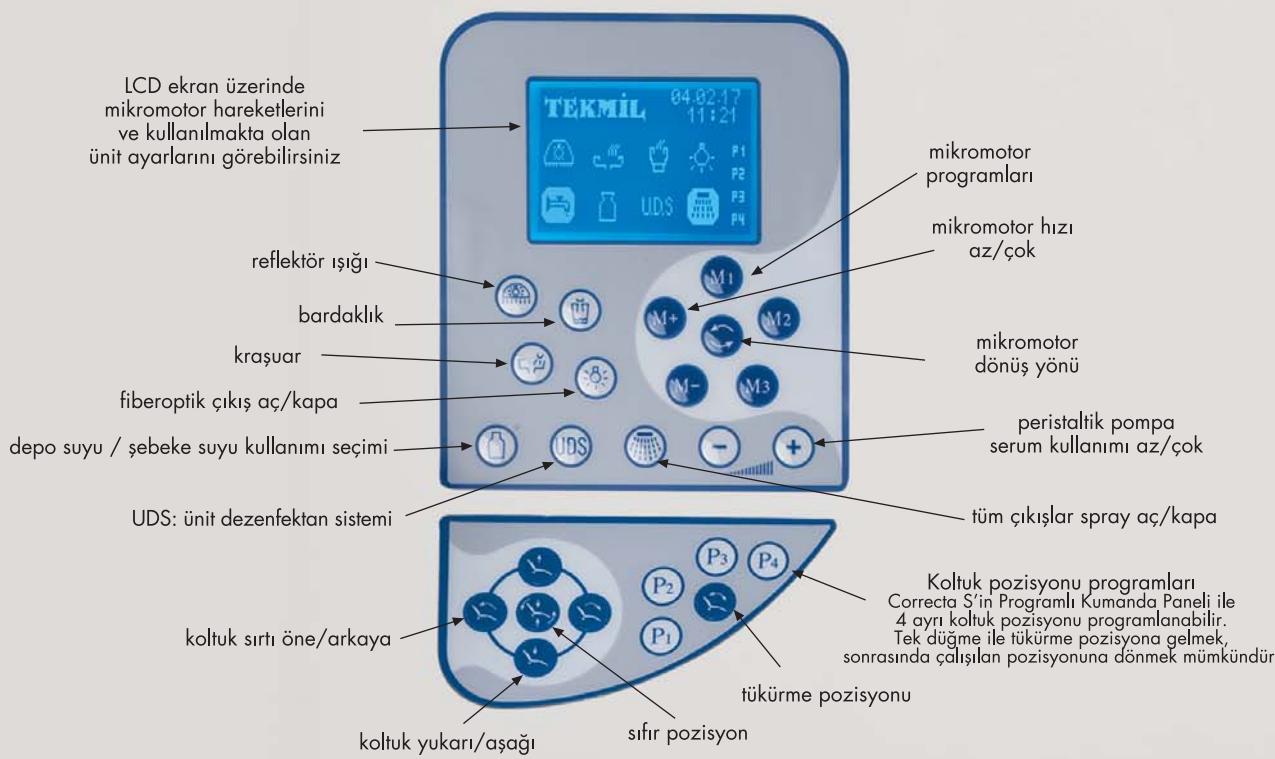



2'si monojet cerrahi aspiratör olmak üzere 4 çıkışla donatılan Support Kol'da diğer çıkışlar hekimin isteğine göre düzenlenir.




Kumanda üzerindeki silikon örtü kolayca çıkarılıp otoklavda sterilize edilebilir.



Kraşuar ve bardaklı çıkışları kolayca sökülp temizlenebilen paslanmaz malzemeden üretilmiştir.

Correcta S Ünit'in kraşuar bölümü tamamı seramikten, hijyenik koşullara uygun, kolayca temizlenebilecek biçimde yapılmıştır.

Hasta konforu için kendi ekseninde sağa ve sola hareketlidir.

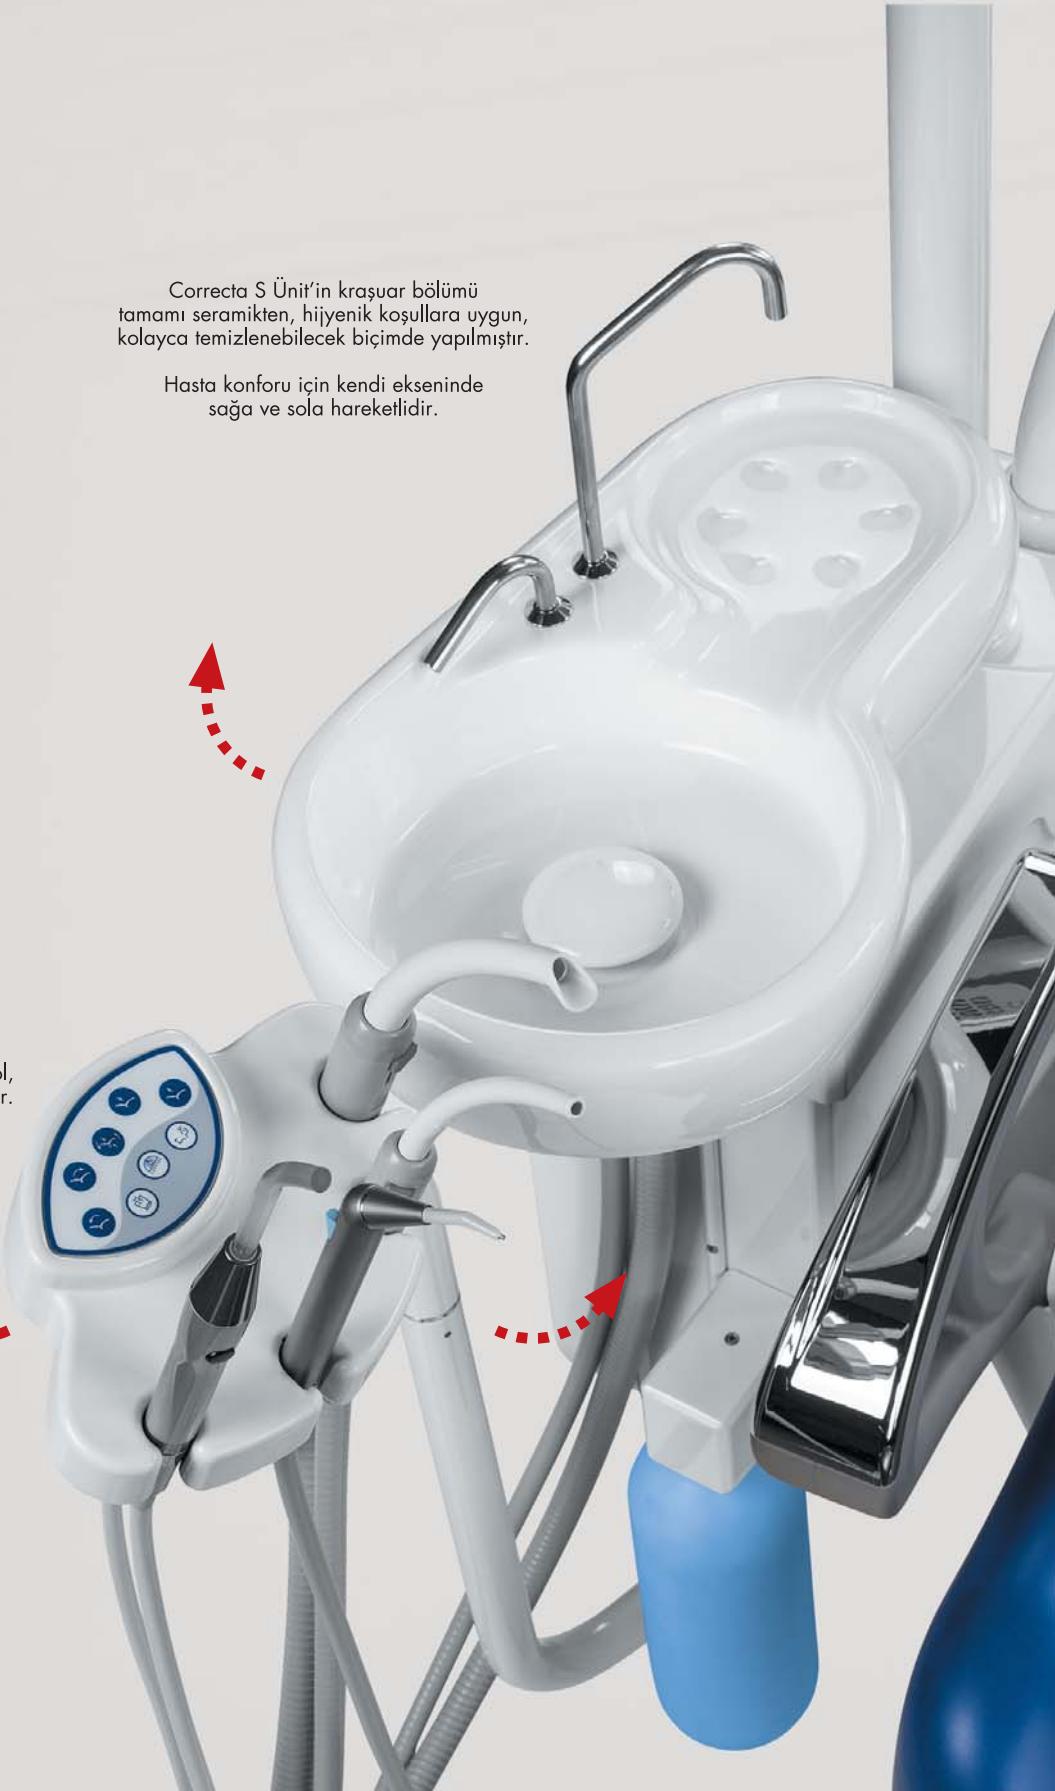

Kendi ekseninde dönen 4 çıkışlı Support Kol, hekimin rahatça çalışabilmesi için tasarlanmıştır.

Kumanda panelinden koltuk hareketleri, kraşuar ve bardaklı fonksiyonlarını kontrol edilebilir.



Correcta S ünitesi reflektörü hekimin talebine göre düzenlenir. Opsiyenel olarak fotoselli, Led'li, Oynar kafa sistem kullanılır.



UDS sistemi : Hijyenik tank içindeki % 3 hidrojen peroksit içeren solüsyonla tüm çıkışlar ve bardaklık çıkışları temizlenerek tam hijyen sağlanır.
Kolayca çıkarılarak, dolumu veya temizliği yapılabilir.

Tek bir düğme ile şebeke suyu veya depo suyu kullanımı tercihi yapmak mümkündür.

Su deposu manyetik kapaklı ünitenin kolayca çıkarılabilir, dolumu veya temizliği yapılabilir.

DENTAL UNIT *Correcta S*



Dar yada geniş koltuk sırtı seçimi



Hasta konforu düşünülerek ergonomik olarak tasarlanan Elegant Foto, hareketli sırt ve yatak bölümümüle hekime istediği çalışma pozisyonunu sağlar.



Programlı veya manuel olarak ayarlanabilen Foto hareketlerinde, kolça hareketli frandelenburg pozisyonu da mevcuttur.



Ünit tabanına sabitlenen kumanda, ağızçı çalışma sırasında hekime kolay harekellerini ayaktan kumanda ile değiştirme imkanı sunar.



Hastanın kolaya oturup kılması için, hareketli sağ kol eklenmiştir



Pnömatik pedal
Chip Blower sistemi,
Su spray kumandalı



Elektrikli - Pnömatik
ve kolluk kumandalı pedal
(Chip Blower sistemi)



Krom ayaklı,
ayak koyma çemberli
hekim taburesi



Arkalsız,
ayak koyma çemberli
hekim taburesi



Çok fonksiyonlu
krom ayaklı,
ayak koyma çemberli
hekim taburesi



Kendi ekseninde dönen tablet, tepsi, support kol, kraşuvvar hastaya konfor hekime çalışma kolaylığı sağlar.

Planet Tetiyer ile
multi axis
hareket imkanı

Çift fonksiyonlu
tasarımı sayesinde,
tetiyer kolayca hastanın
en rahat olacağı
konuma getirilir.
Engelli hastalar için de
kullanımı mümkündür.



DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 13485
Medical Devices Directives 93-42

CE 1984



DİS HEKİMLİĞİ CİHAZLARI

📍 İnönü Mahallesi Çayır Sokak No.43 Harbiye-Şişli-İstanbul / TURKEY
 ☎ +90 212 233 7837 📲 +90 212 231 7277 📩 satis@tekmil.com.tr
 230 4986 💬 +90 545 96367 26 🌐 www.tekmil.com.tr